



## Produktinformation

Pulse-Lavage-System Spülset

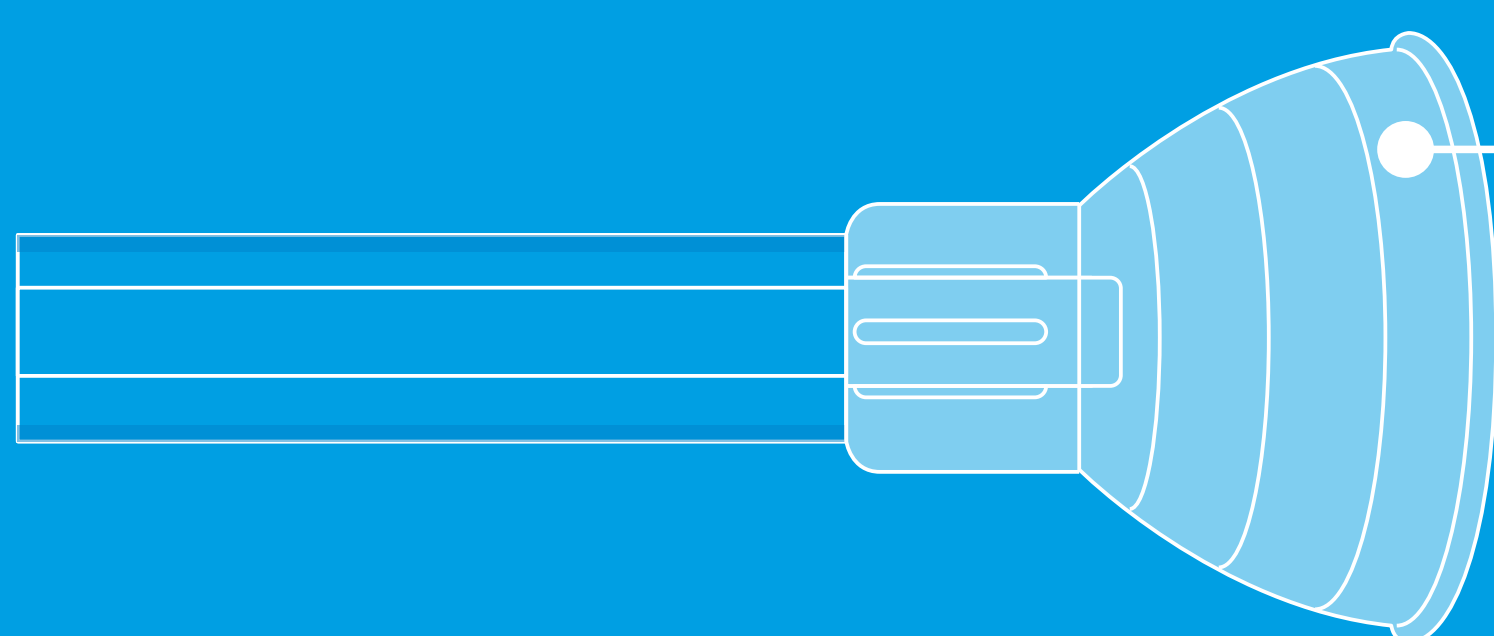

### Spülset-Absaugung

Der Spritzschutz ist flexibel und so konzipiert, dass er sich z.B. der Knochenoberfläche anpassen kann. Die Stoppfunktion gewährleistet auch bei höherem Druck kein Zurückrutschen des Spritzschutzes. Sie können den Spritzschutz zu jederzeit abnehmen und wieder aufbringen.

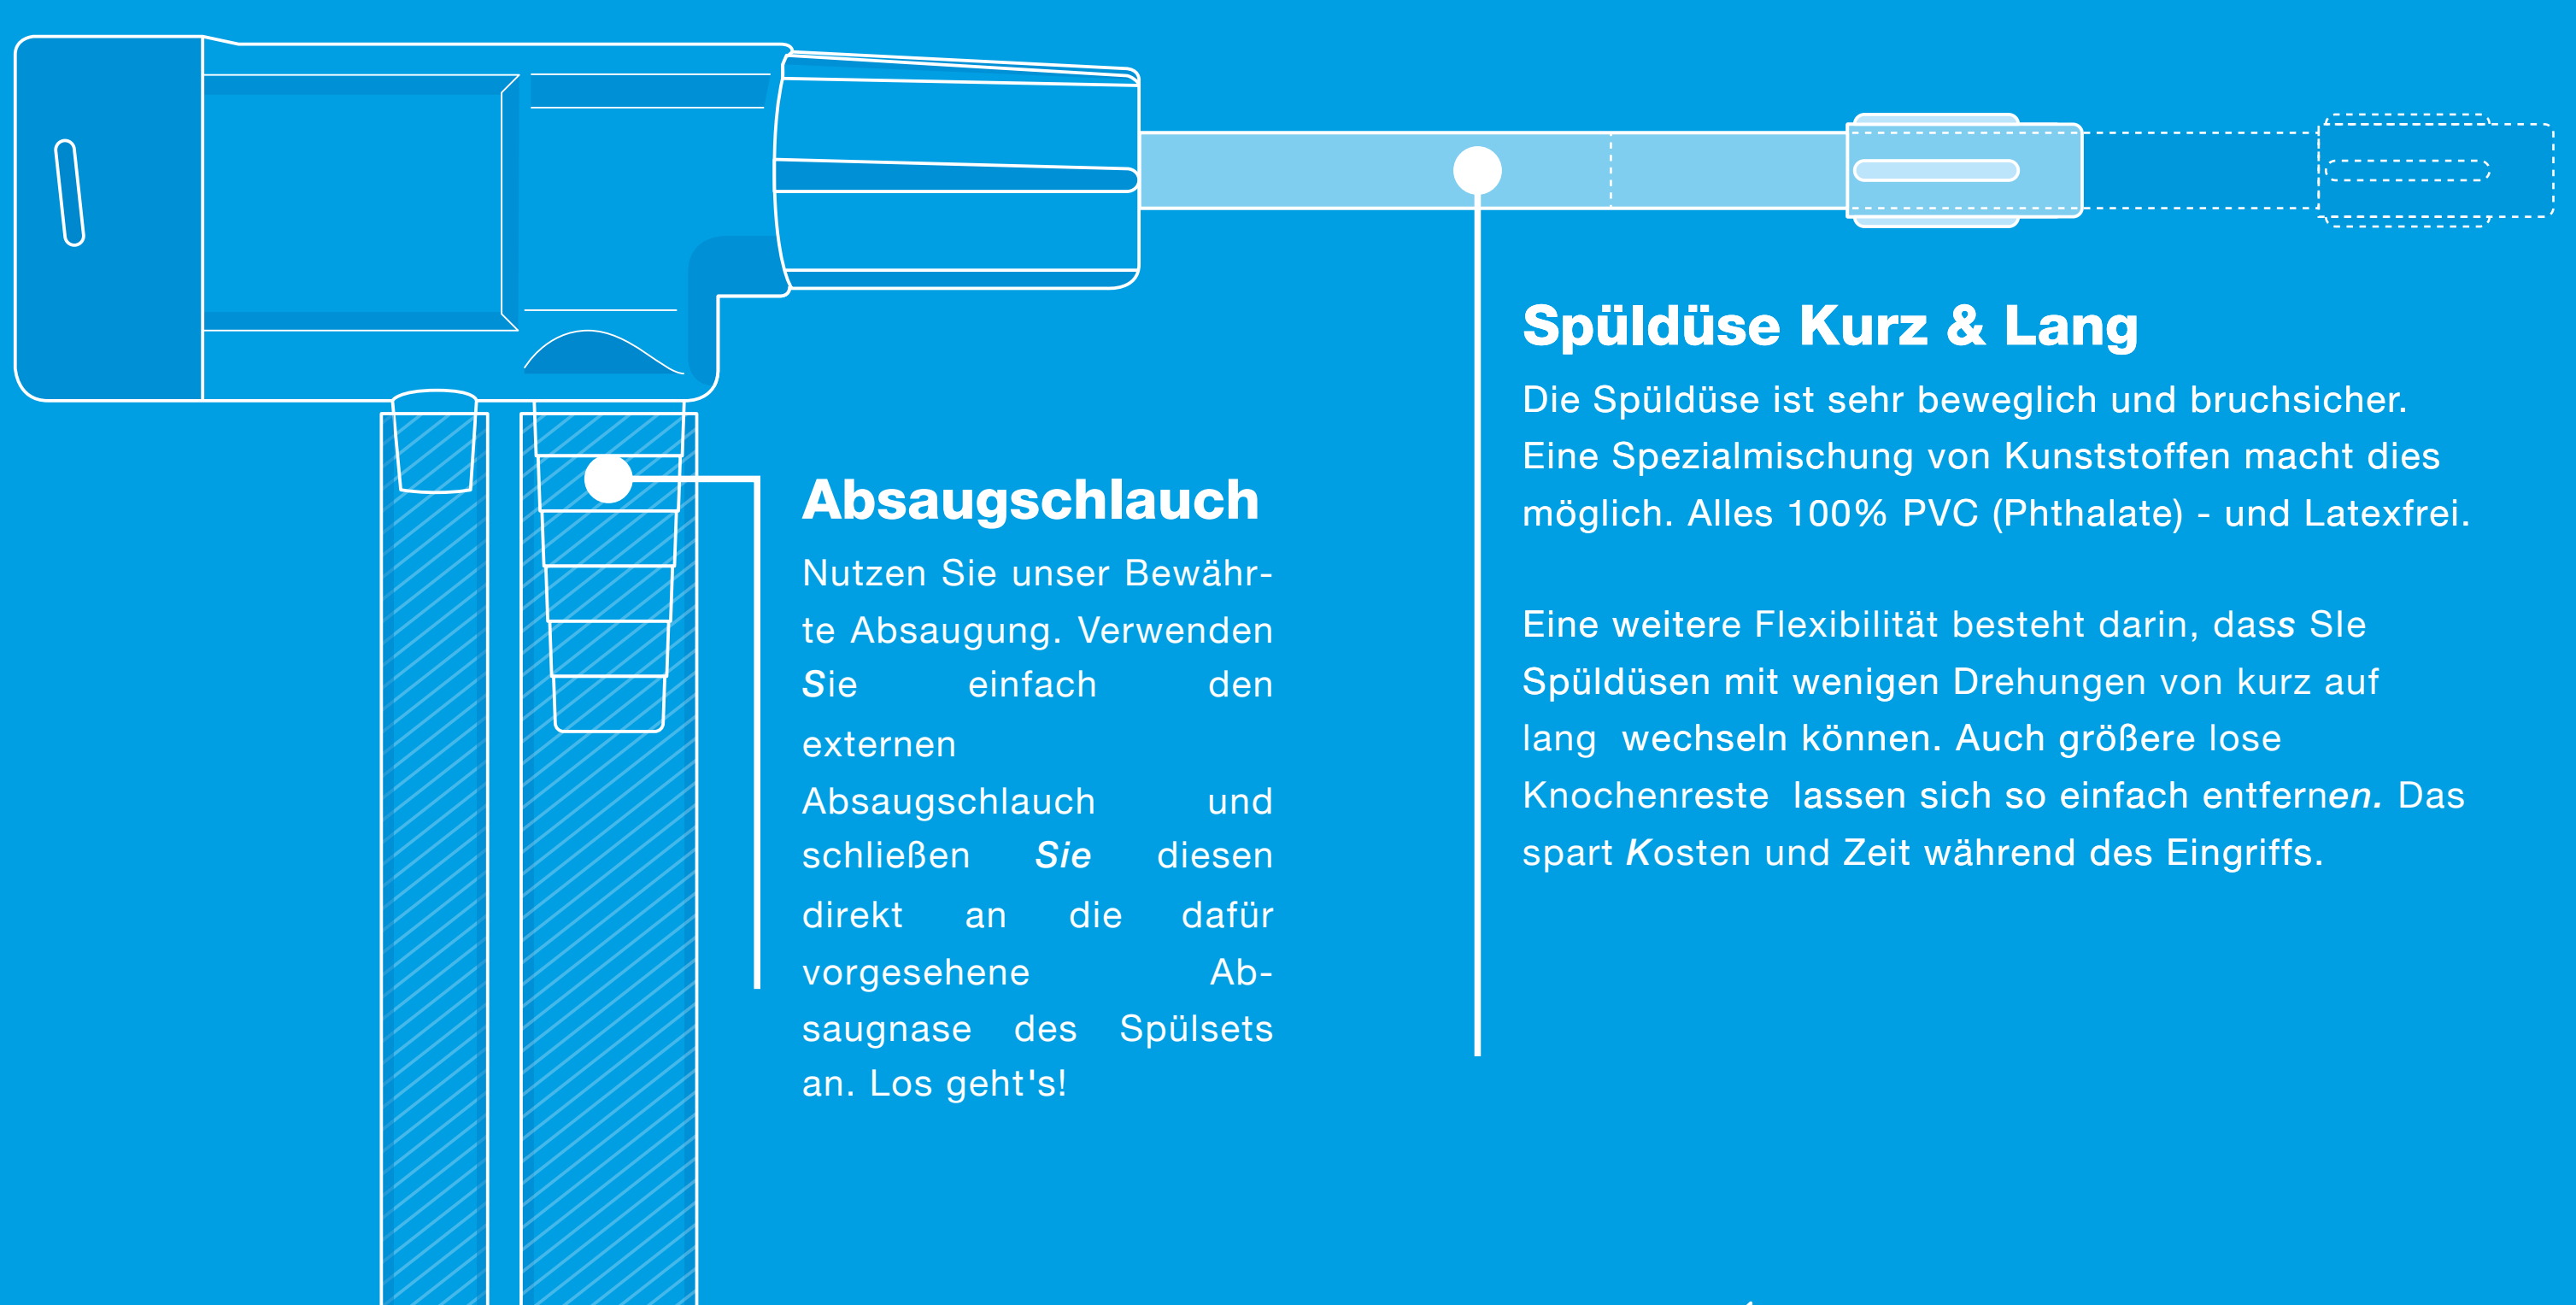


### Absaugschlauch

Nutzen Sie unser Bewährte Absaugung. Verwenden Sie einfach den externen Absaugschlauch und schließen Sie diesen direkt an die dafür vorgesehene Absaugnase des Spülsets an. Los geht's!

### Spüldüse Kurz & Lang


Die Spüldüse ist sehr beweglich und bruchsicher. Eine Spezialmischung von Kunststoffen macht dies möglich. Alles 100% PVC (Phthalate) - und Latexfrei.

Eine weitere Flexibilität besteht darin, dass Sie Spüldüsen mit wenigen Drehungen von kurz auf lang wechseln können. Auch größere lose Knochenreste lassen sich so einfach entfernen. Das spart Kosten und Zeit während des Eingriffs.

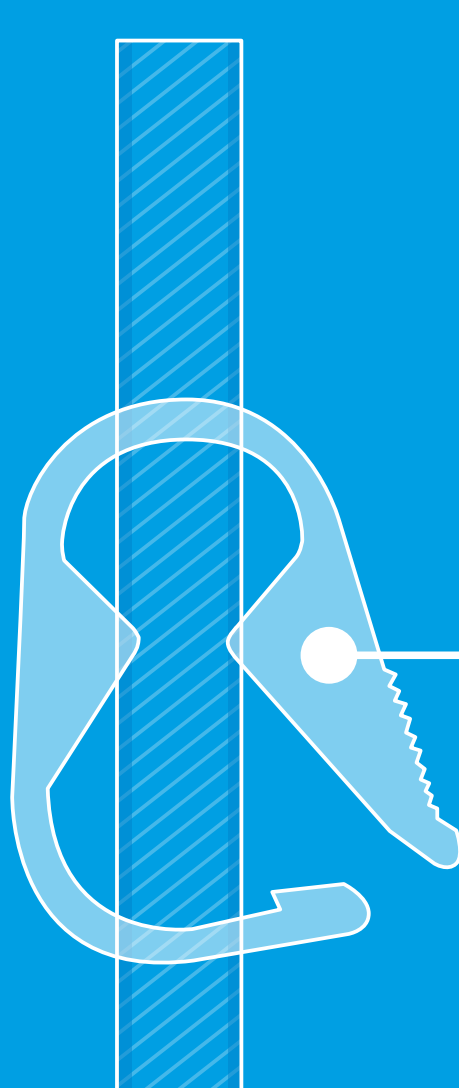

### Clip

Der Clip verfügt über zwei Stellungen, AUF und ZU. Das verhindert, dass zwischenzeitlich Flüssigkeit aus der Öffnung treten kann.

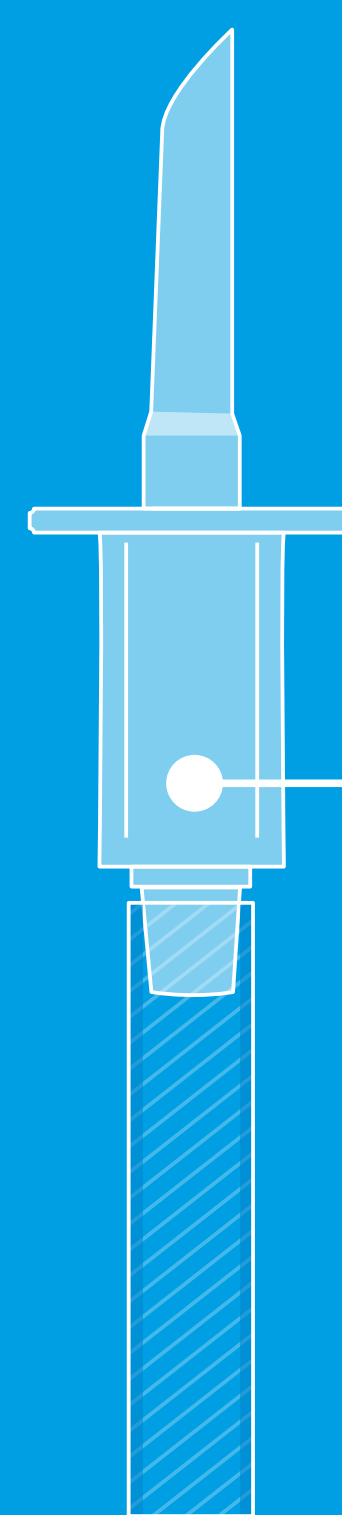

### Spike

Der Spike ist stabil und seine Spitze ermöglicht eine schnelle Konnektierung.

Innovatives und fortschrittliches Handeln

## Mehr Patientensicherheit

Verarbeitung hochwertigster Materialien  
Alle flexiblen Materialien sind PVC/Phthalate/Latex-frei,  
geprüft und ausgezeichnet mit dem  
„Phthalate Free“-Siegel.

Das bestätigt Ihnen auch der Test unserer Sets beim Fresenius Institut.  
Mehr dazu auf unserer Website  
[www.interatio-meditec.de](http://www.interatio-meditec.de)

**PHthalate®  
FREE**

### Produkt

Neptunus Hüfte-Knie-Set  
mit Absaugung

### Inhalt pro Set/Bezeichnung

Spülset mit Absaugung inkl. Spüldüse kurz,  
Spüldüse lang und Spritzschutz

### Menge pro VE

10 Stück

### Bestell-Nr.

OMP9100



**INTERATIO-MediTec**  
Medizintechnik Vertriebs-GmbH  
Hochstraß 5  
94377 Steinach

+49 9428 90190-0

info@interatio-meditec.de